


Embolización Aneurisma Cerebelosa superior izquierda


Dr. Santiago Rosati
Neurorradiología Intervencionista.

RM CEREBRAL

Muestra aneurisma parcialmente trombosado que ejerce efecto de masa sobre del tronco del encéfalo.

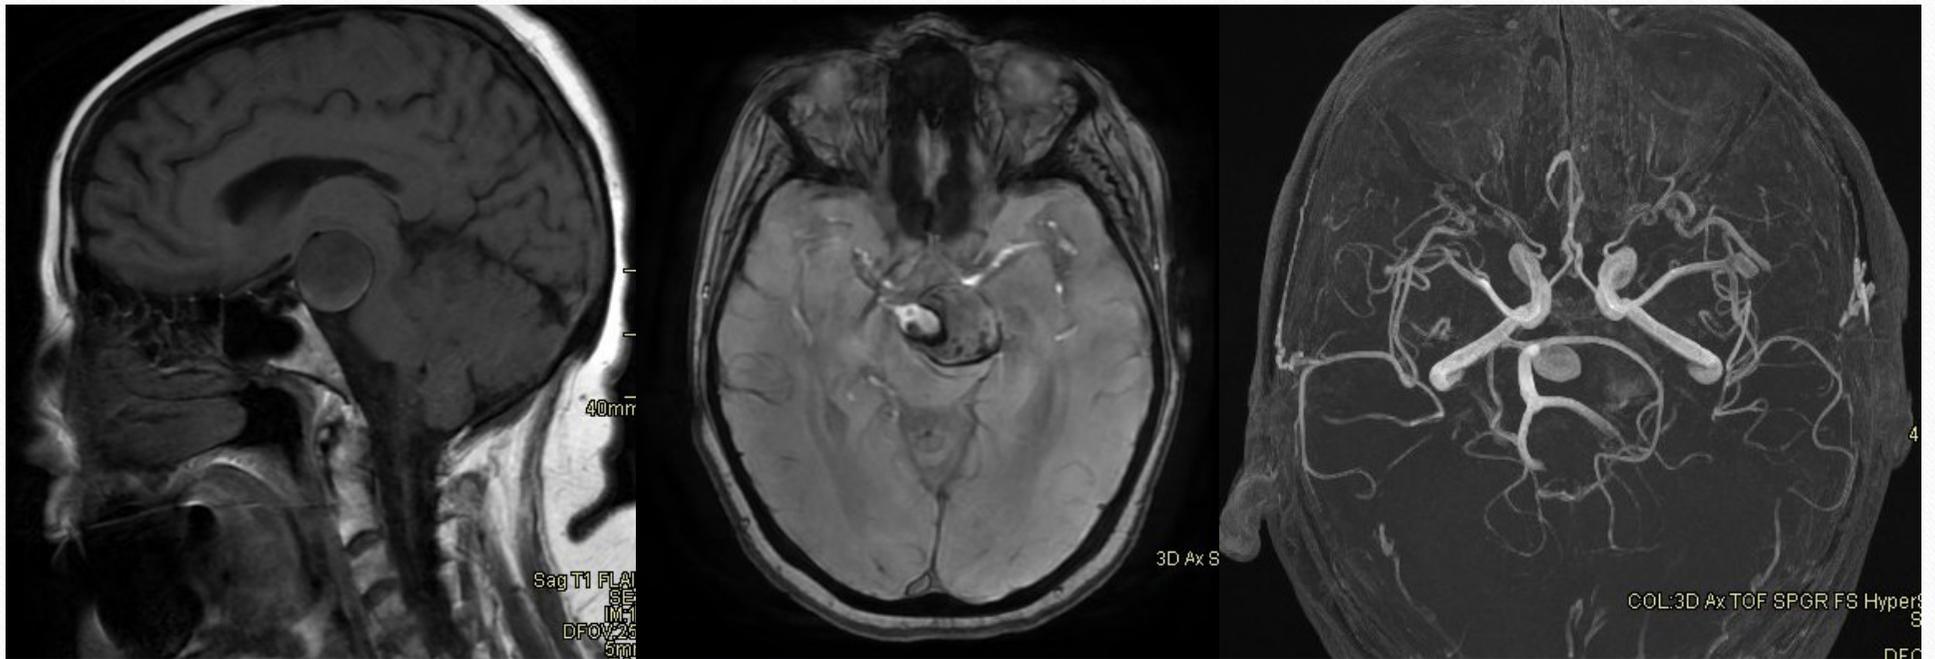


3D dimensiones aneurismáticas

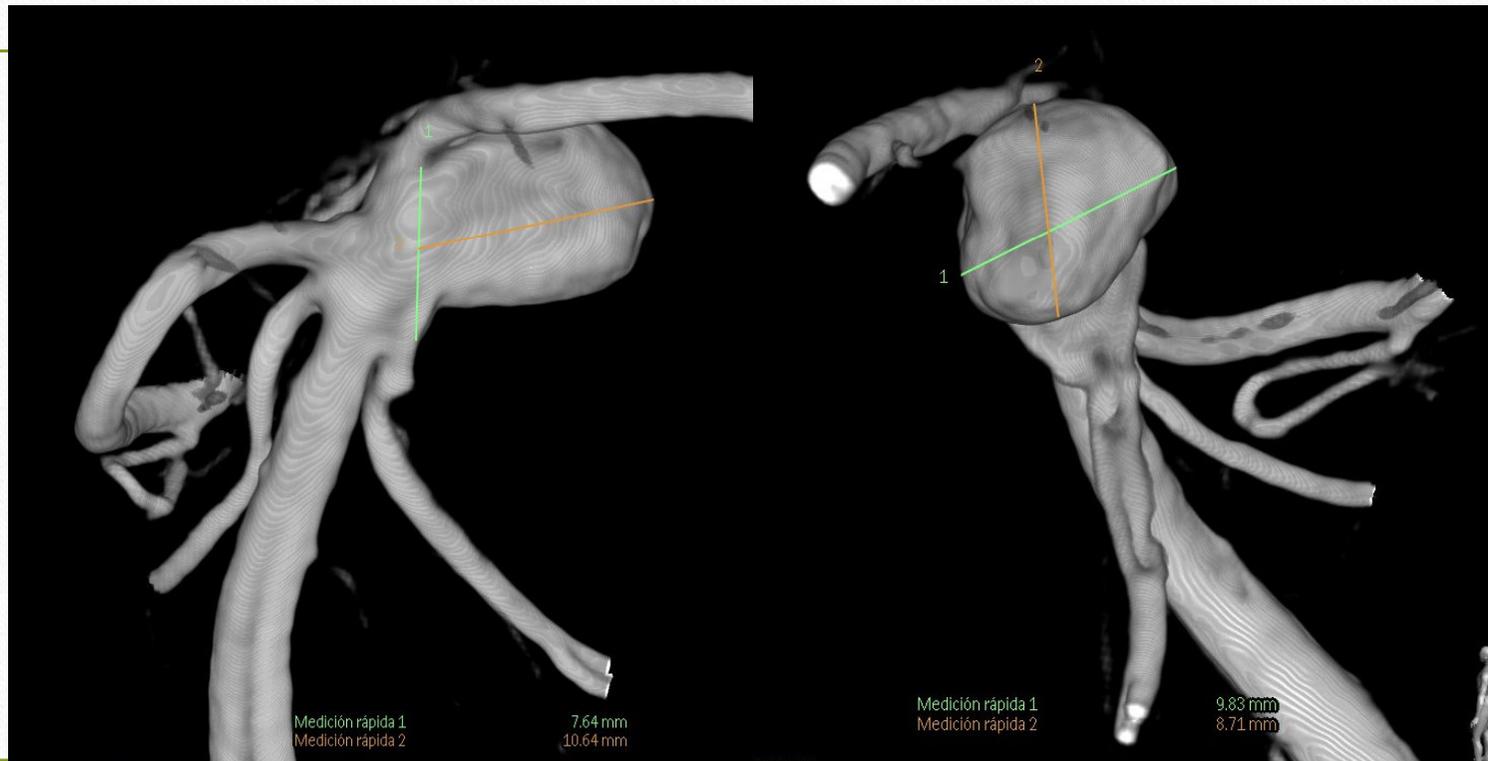


Se realiza microcateterismo del saco con microcatéter SL10 y se libera un primer coil de cesta
(Target 360 XL 12x45)

Posterior despliegue de stent Accero desde el segmento P2 de la ACP izquierda al tercio medio
de la basilar.

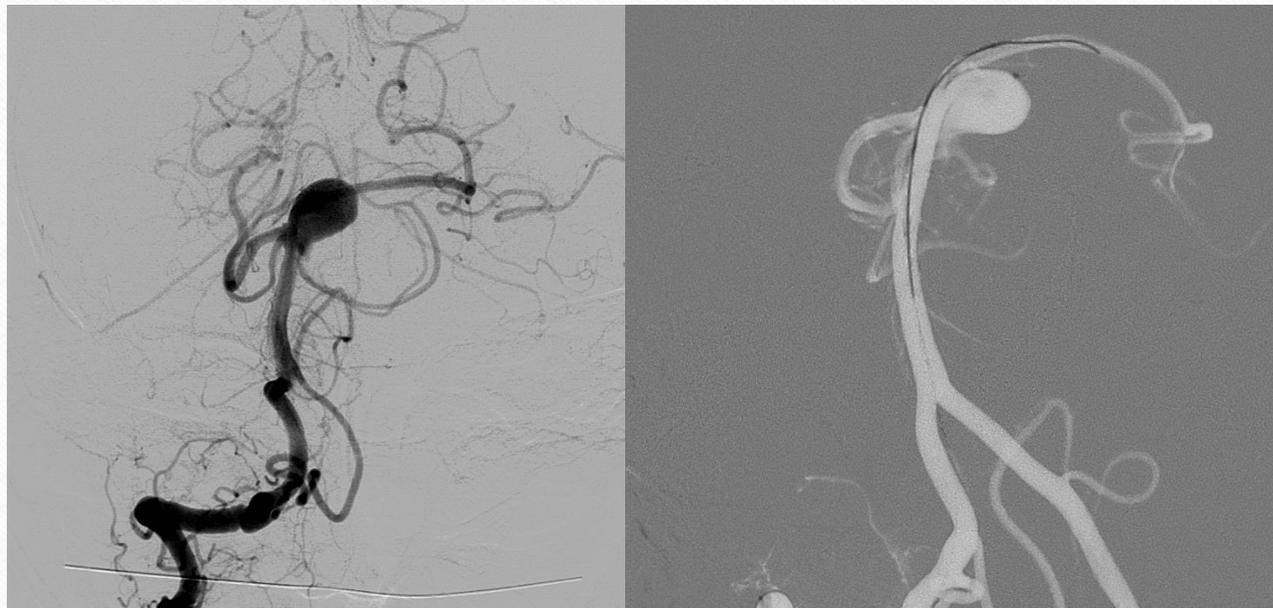

A continuación se termina de rellenar el saco aneurismático con 6 coils de relleno mediante técnica de jailing: Target Helical XL 7x20; Target Helical XL 7x20; Target Helical XL 6x20; Target Helical XL 5x15; Target Helical Ultra 4x8; Target Helical Ultra 4x8

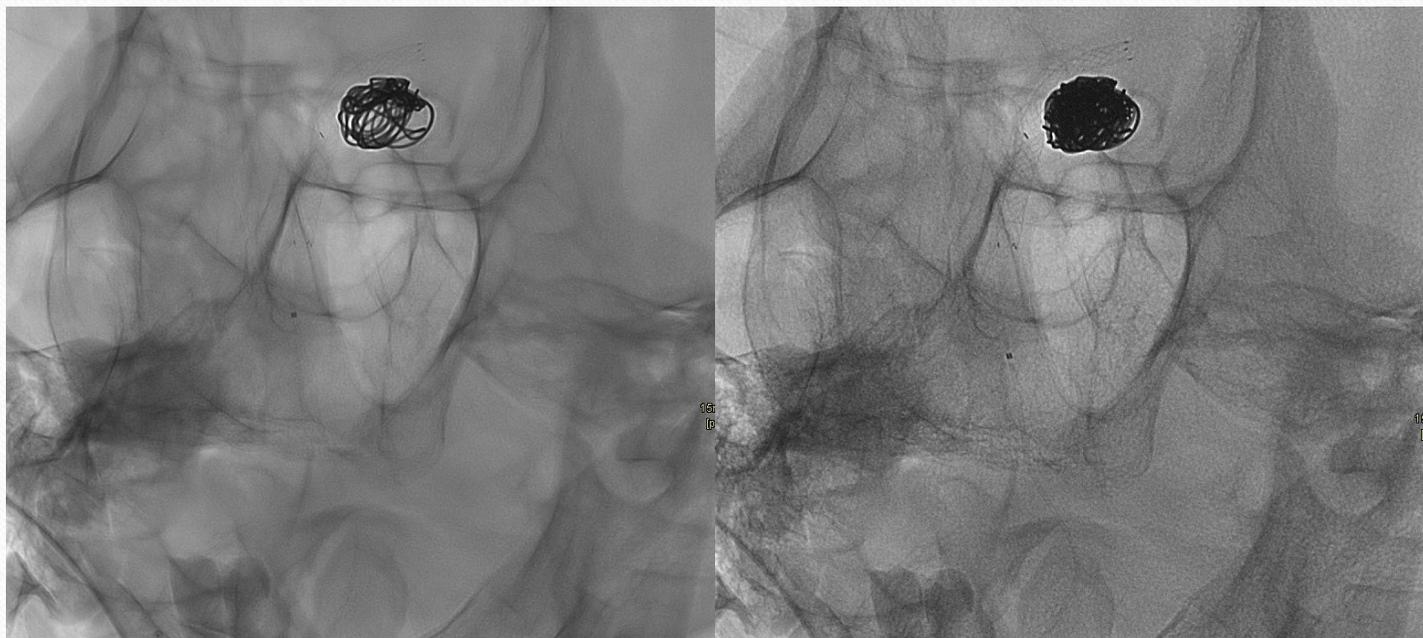

Consiguiendo un grado de compactación del 24%. Series de control tras finalizar el procedimiento sin complicaciones, con cuello residual (Raymond final: 2).

